

# Fehlendes Patientenarmband



1

## Fallbeschreibung:

Weil eine neue Venenverweilkanüle gelegt werden musste, wurde das vorhandene Patientenidentifikationsarmband entfernt. Allerdings wurde es nicht (wie in der entsprechenden Dienstanweisung vorgegeben) durch ein neues Armband ersetzt. Weil der/die Patient\*in auf verschiedene Medikamente allergisch reagiert, hätte das Fehlen des Armbandes (an dem auch Allergien erkennbar sind) zu Zwischenfällen führen können. Der Fehler wurde noch rechtzeitig erkannt.

## Analysegedanken:


Dieser Fall aus dem CHC zeigt eine **typische Fehlerkette** auf.

Ausgangspunkt der Fehlerkette war, dass eine neue Venenverweilkanüle gelegt werden musste und dies im nächsten Schritt zu einem Entfernen des ursprünglichen Armbandes führte.

Das Fehlen des Armbandes wurde noch rechtzeitig erkannt, bevor dies zu einem kritischen Ereignis, wie einer Verwechslung oder einem Übersehen der Allergie geführt hat.

Die Fehlerkette wurde also noch rechtzeitig unterbrochen und ist im folgenden grafisch dargestellt.

## Fehlerkette:

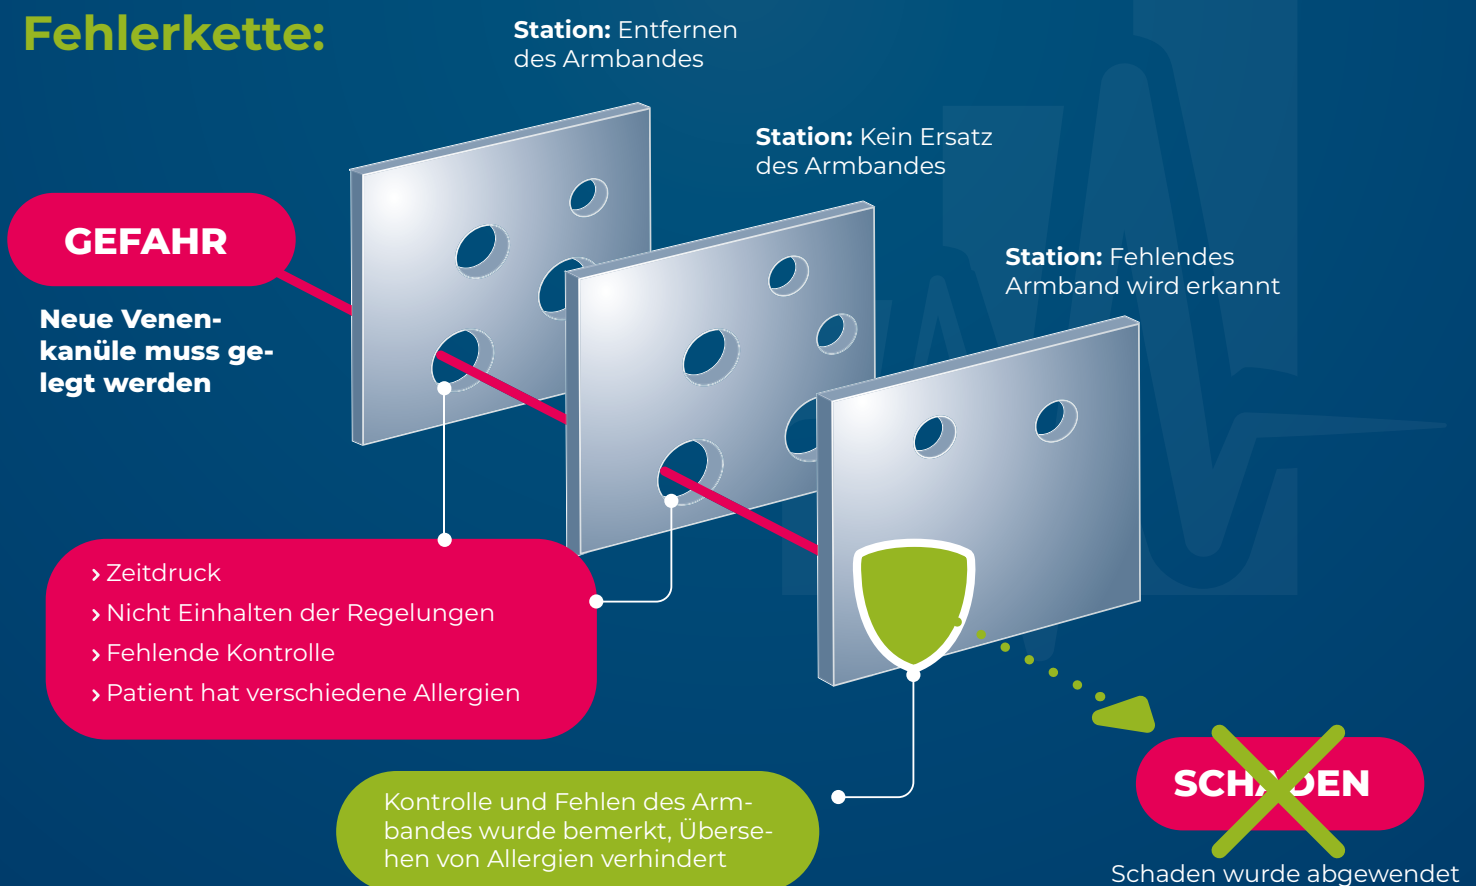


## Mögliche Ursachen:

Nichteinhaltung der vorgegebenen Regelungen.  
Zeitdruck

## Maßnahmenvorschläge:

- ✓ Schulung der Mitarbeiter\*innen und erneute Bekanntmachung der Inhalte der Dienstanweisung im Rahmen der Teambesprechungen.
- ✓ Stop Check Act und sorgsame Kontrolle nach dem Entfernen eines Armbandes, ob ein neues Armband wieder angelegt wurde (Richtiges Armband? Am richtigen Patienten?).

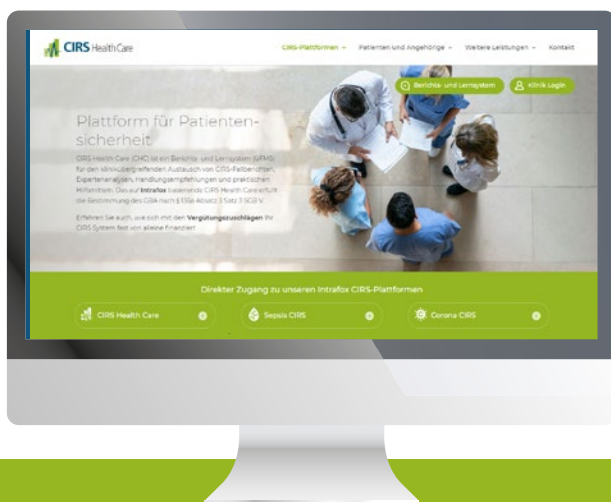

Weitere Infos auf:  
<https://www.cirs-health-care.de>



*CIRS Health Care – eine Leistung von:*



InPASS -GmbH  
Friedrich-Naumann-Str. 13  
72762 Reutlingen

Tel.: 07121 923807  
E-Mail: [institut@inpass.de](mailto:institut@inpass.de)



Inworks GmbH  
Hörvelsinger Weg 39  
89081 Ulm

Markus Tannheimer  
Geschäftsführer

Telefon: +49 (0)731 938070  
E-Mail: [info@inworks.de](mailto:info@inworks.de)

